

Testi Yapan
Cihaz

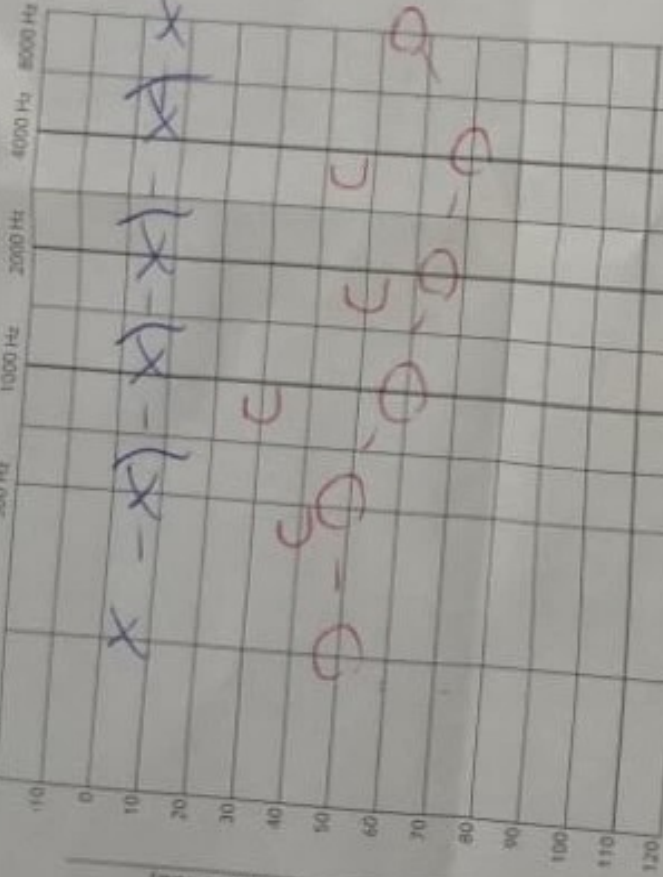
Adı Soyadı: Enschan

Hasta no: 24212

Doğum Tarihi: / /

Cinsiyeti: E K

Tarih: 06.12.2020

**SEMBOLLER**

	Sağ (Kr.)	Sol (Mavri)
Hava	0	X
Maksiz	(B)	(X)
Kemik	e	>
Maksiz	[]

SAF SES ORTALAMASI (500-2000 HZ)

	Sol	Sağ
Hava	55 dB	58 dB
Kemik	55 dB	60 dB

KONUŞMAYI ALMA EŞİĞİ (SRT)

Çift/Hpir	Sağ	Sol	Aletle
	10 dB	20 dB	

**KONUŞMAYI AYIRTETME
"SPEECH DISCRIMINATION"**

Çift/Hpir	Sağ	Sol	Aletle
	96 %	88 %	
	50 dB	40 dB	

Verilen Sesin İyileme Seviyesi

EN RAHAT SES YÜKSEKLİĞİ "MCL"

Çift/Hpir	Sağ	Sol	Aletle
	50 dB	40 dB	

TEDİRĞİN EDİCİ SES YÜKSEKLİĞİ "UCL"

Çift/Hpir	Sağ	Sol	Aletle

WEBER	SAG	SOL	SAG	SOL
SISI	%	%	%	%
-tone				
decay				

SAĞ DELTA-İLERİ MIXED TIP
İŞİTME KARSISI

Kolan Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktora Terahütleri Uzmanı

ÖZEL SİLİVRİ KOLAN HOSPITAL

ÖZEL SİLİVRİ KOLAN HOSPITAL

ÖZEL SİLİVRİ KOLAN HOSPITAL

Arl Silivri Kolan Hastanesi

Sıvgı CEYLAN

Odyometristi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları